

## JMS エキステンションチューブ(一部規格) 仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

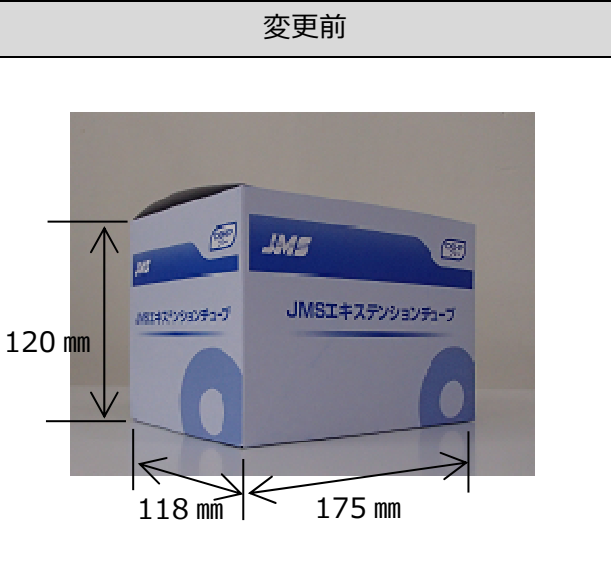
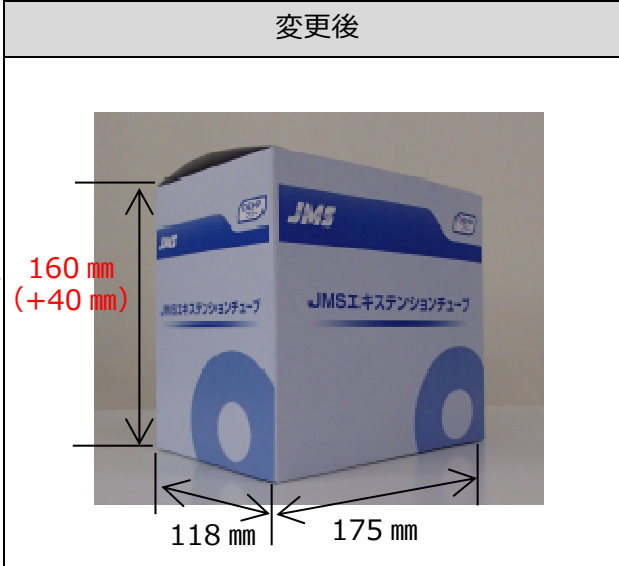
さてこの度、JMS エキステンションチューブの一部規格につきまして、下記の通りの仕様変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

変更前	変更後
	
<b>変更点</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内箱の高さが現行より約4cm高くなります。</li> <li>・変更に伴い外箱の奥行も約10cm(265mm→360mm)大きくなります。</li> </ul>

#### ■対象規格 販売名：JMS エキステンションチューブ

品番	JANコード	型式
JV-ND2050PC	4987494088843	DEHPフリー ND2 500mm

#### ■変更時期

2019年4月12日以降、変更品にて生産を開始いたします。

※お客様のお手元に届く時期として、5月以降を予定しておりますが、在庫状況により流通時期が前後する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

※上記変更内容に伴う品番及び統一商品コード(JANコード)の変更は有りません。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601