



JMS 採血針・JMS 注射針統合のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、JMS 採血針を JMS 注射針へ統合させて頂くこととなりましたので、ご案内を致します。

皆様には日々ご繁忙の折、大変お手数をおかけすることになりますが、今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

■対象製品：現行

販売名称：JMS採血針

品番	販売名称	型式	JANコード	入数	備考
JS-NB1919SP	JMS採血針	19G×3/4"	4987494023462	100本/箱 × 40箱	統合該当品
JS-NB2016SP	JMS採血針	20G×5/8"	4987494023479	100本/箱 × 40箱	統合該当品
JS-NB2116SP	JMS採血針	21G×5/8"	4987494023486	100本/箱 × 40箱	統合済 (JS-NR2116SP)
JS-NB2216SP	JMS採血針	22G×5/8"	4987494023493	100本/箱 × 40箱	規格廃止

承認/許可番号:15100BZZ00684000

■対象製品：統合後

販売名称：JMS注射針

品番	販売名称	型式	JANコード	入数	備考
JS-NR1919SP	JMS注射針	19G×3/4"RB	4987494293070	100本/箱 × 40箱	
JS-NR2016SP	JMS注射針	20G×5/8"RB	4987494293094	100本/箱 × 40箱	
JS-NR2116SP	JMS注射針	21G×5/8"RB	4987494253258	100本/箱 × 40箱	

承認/許可番号:14300BZZ00177000

■変更理由及び変更時期

此度、JMS 採血針の滅菌方法をガンマ線滅菌から、電子線滅菌へ変更させて頂く事となりました。

JMS 採血針の使用目的は、既に電子線滅菌へ変更をした JMS 注射針の認証の使用目的にある採液、採血に含まれることから、この機会に、JMS 採血針を JMS 注射針に統合させて頂く事となりました。

(JMS 採血針の承認/使用目的) 人工腎臓又は人工心肺の血液回路の混注部より検査用の血液を採取するために用いられる注射針であって、そのままただちに使用でき、且つ、1回限りの使用で使い捨てるものである。

(JMS 注射針の認証/使用目的) 注射用医薬品注入、採液、採血に用いる。

2017年12月以降、現行規格の在庫が無くなり次第、順次変更致します。


■包装変更内容

例) 現行/JMS採血針 JS-NB2116SP ⇒ 統合後/JMS注射針 JS-NR2116SP

【現行/個包装表示】




【統合後/個包装表示】




【現行/内箱表示】




【統合後/内箱表示】



【現行/外箱表示】

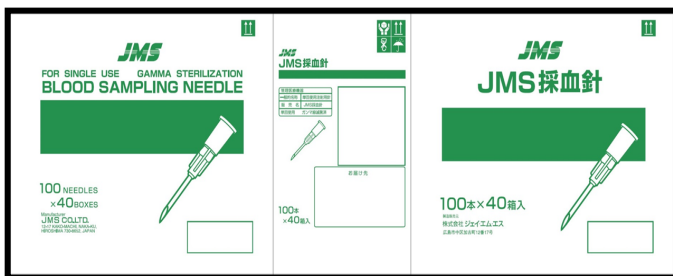

【統合後/外箱表示】



(滅菌方法が、変更致します。 現行/ガンマ線滅菌 (製品本体の仕様変更はございません。))

統合後/電子線滅菌)

以上

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 082-218-0602