

## 採尿管セット仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、この度、採尿管セットにつきまして、下記の通り仕様変更を致しますのでご案内致します。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 変更内容

- 採尿管蓋部形状が「ソケルダ-付」から「ソケルダ-無」に統一となります。

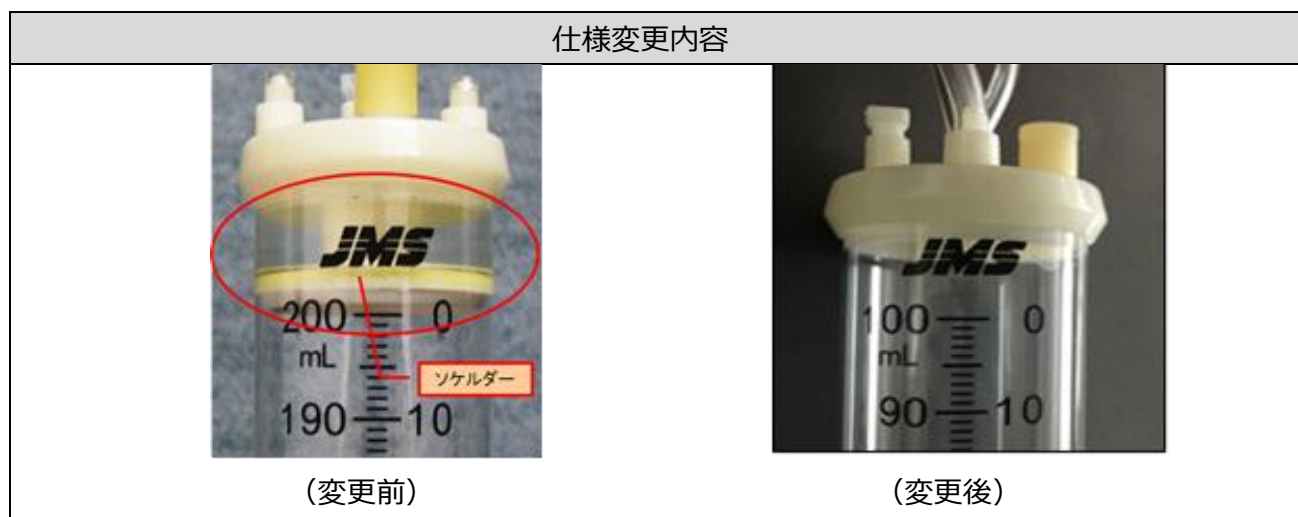

### 変更時期

2018年3月以降の生産品より、随時変更致します。

※お手元に届く時期として5月以降を予定していますが、在庫状況により流通時期が前後する場合がありますので、予めご了承ください。

### 対象規格

販売名	型式名	【変更前】 ソケルダ-付		⇒	【変更後】 ソケルダ-無	
		品番	JANコード		品番	JANコード
JMS採尿管セット	100mL	JU-M10C	4987494157495	⇒	JU-M10C01	4987494173389
JMS採尿管セット	100mL	JU-M10R	4987494158195	⇒	JU-M10CR	4987494035786
JMS採尿管セット	200mL	JU-M20C	4987494157488	⇒	JU-M20C	4987494295258
JMS採尿管セット	200mL	JU-M20R	4987494158188	⇒	JU-M20R	4987494295265
JMS採尿管セット	200mL	JU-M20R02	4987494041084	⇒	JU-M20R02	4987494295272
JMS採尿管付ドレンバッグ	A 100mL	JU-M10AL	4987494111206	⇒	JU-M10AL	4987494295289
JMS採尿管付ドレンバッグ	A 200mL	JU-M20AL	4987494111213	⇒	JU-M20AL	4987494295296
JMS採尿管付ドレンバッグ	A 100mL	JU-M10AL01	4987494111237	⇒	JU-M10AL01	4987494295302

○JU-M10CとJU-M10Rは、品番及びJANコードが変更となります。

○その他規格は、JANコードのみ変更となります

○入数、価格の変更はありません。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601