

バイポーラペーシング用バルーンカテーテル トレイ変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、バイポーラペーシング用バルーンカテーテルについて、トレイを変更いたしますので、ご案内申し上げます。


今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

- ・トレイメーカーの変更により、トレイのデザインを変更

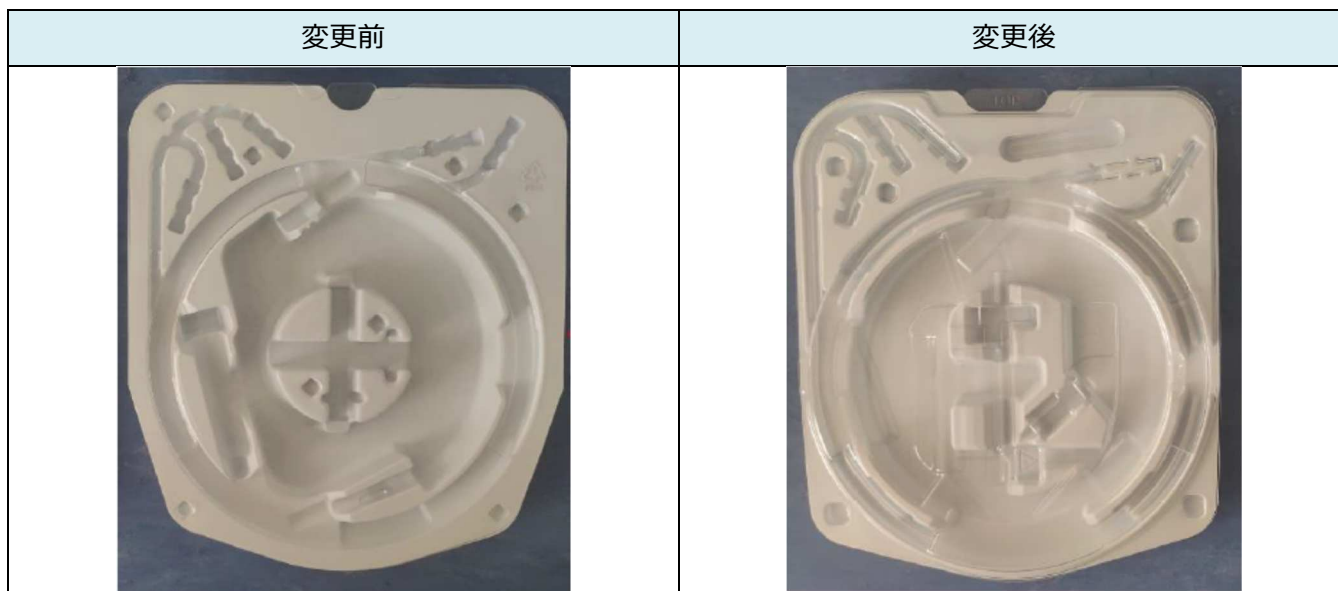

対象規格

販売名：バイポーラペーシング用バルーンカテーテル

医療機器承認番号：16300BZY01104000

変更時期

2022年7月末（ロット番号：22D26844以降）から旧トレイの在庫がなくなり次第、順次変更となります。

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当へご確認ください。

以上