

JMS 輸液セット（アイフューザー用）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

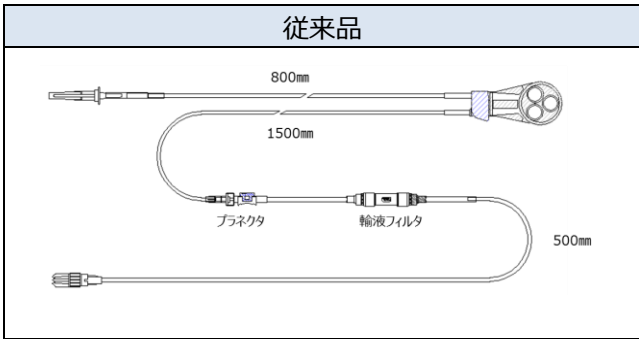
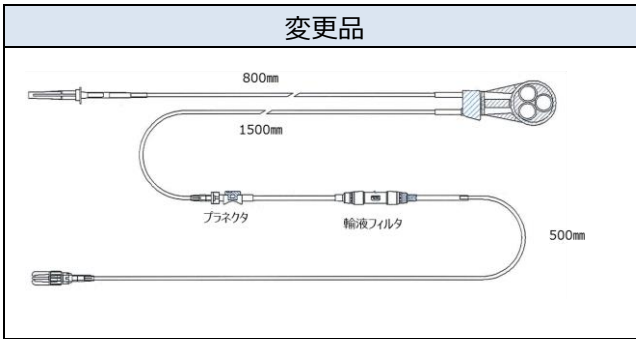
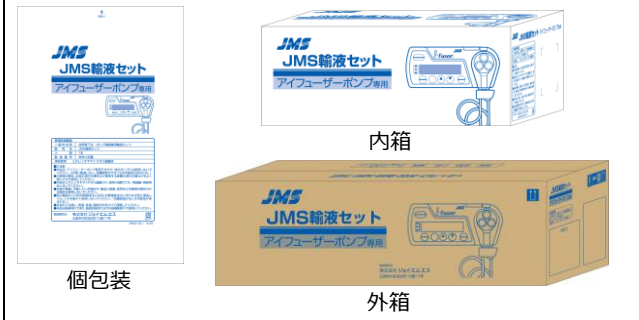

さて、この度、JMS 輸液セットにつきまして、下記の通り仕様変更のご案内をいたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

従来品	変更品
	
	
変更内容	<ul style="list-style-type: none"> 販売名をアイフューザー輸液セットに変更 個包装、内箱、外箱デザインを変更

従来品

販売名	品目コード	品番	品名	JANコード
JMS輸液セット	016500201	JE-IFT001	IF 11† IVF PN1 FL500	4987494232246

変更品

販売名	品目コード	品番	品名	JANコード
アイフューザー輸液セット	016800640	JE-IFP3PFL	IF E2IVF1WPN1 FLDEHPF	4987494307623

変更時期

在庫がなくなり次第、順次変更になります。

以上